


Addendum SurePower™ II -- Guide de l'opérateur du chargeur SurePower™

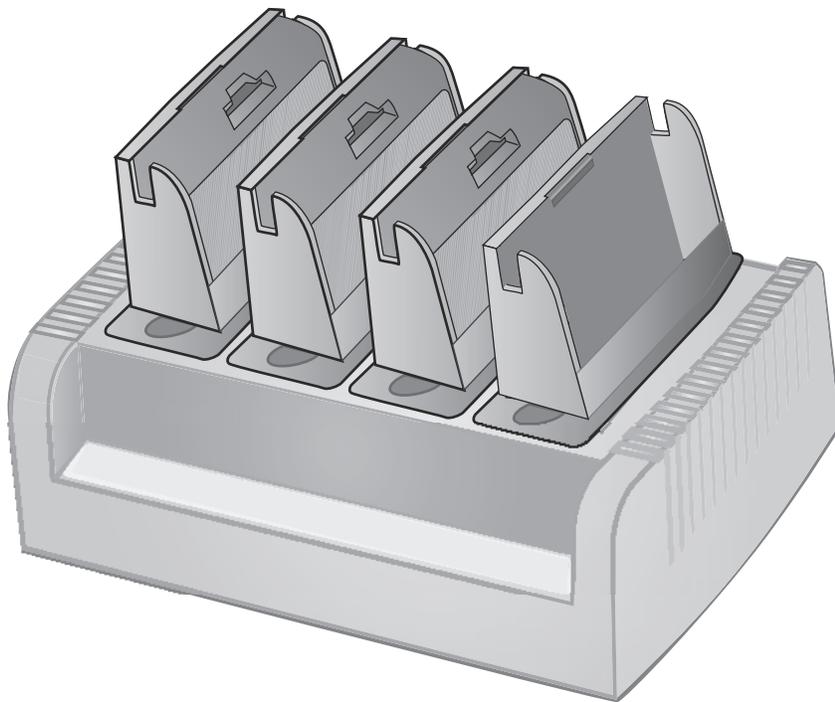

ZOLL®

9652-000397-02 Rev. C

L'addendum *SurePower*™ II du Guide de l'opérateur du chargeur *SurePower*
(REF 9652-000397-02 Rev. C) a été imprimé en mars 2022.

SurePower, X Series et ZOLL sont des marques ou des marques déposées de ZOLL Medical Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Copyright © 2022 ZOLL Medical Corporation. Tous droits réservés.



ZOLL Medical Corporation

269 Mill Road
Chelmsford, MA USA
01824-4105



EC REP

ZOLL International Holding B.V.

Newtonweg 18
6662 PV ELST
The Netherlands

CH REP

ZOLL Medical Switzerland A.G.

Bahnhofstrasse 20
6300, Zug
Switzerland



0123

SurePower™ II -- Guide de l'opérateur du chargeur SurePower™

Cet addendum fournit des informations spécifiques à l'utilisation du chargeur ZOLL® Medical Corporation *SurePower™* en ce qui concerne les tests, le recalibrage et la charge de la batterie *SurePower™ II*.

Pour des informations générales sur l'utilisation du chargeur *SurePower™*, les avertissements, précautions et remarques généraux, se reporter au Guide de l'opérateur du chargeur *SurePower™* (9650-0535-02, Révision B ou supérieure).

Il est important que vous lisiez et compreniez les informations contenues dans cet addendum et le **Guide de l'opérateur du chargeur SurePower™**. Le fonctionnement des unités X Series™ et Propaq® M/MD repose sur le chargement et l'entretien corrects des batteries *SurePower II*.

Sécurité

Le paragraphe qui suit comporte des avertissements, des précautions et des remarques sur l'utilisation de la batterie *SurePower II* avec le chargeur SurePower. Risque de pincement lors de la mise en place d'une batterie ou d'un adaptateur pour chargeur SurePower II dans un compartiment.

Avertissement

- Risque de pincement lors de la mise en place d'une batterie ou d'un adaptateur pour chargeur SurePower II dans un compartiment.

Précaution

- Lors de l'utilisation du chargeur SurePower pour charger et tester les batteries *SurePower II*, veillez à disposer d'adaptateurs pour chargeur utilisables avec le chargeur.
- Ne stockez pas de batteries dans les adaptateurs pour chargeurs, au risque que la batterie ne se décharge plus vite.

Remarque

- L'utilisation des adaptateurs pour chargeur *SurePower II* ne modifie pas les fonctions du chargeur SurePower : toutes les fonctions du chargeur SurePower sont telles que décrites dans le guide de l'opérateur correspondant (9650-0535-02, Révision B ou supérieure).
- Si vous retirez la batterie avant la fin de la charge, le chargeur SurePower émet une alerte sonore.
- Si un test de capacité de la batterie complètement chargée n'est pas satisfaisant et si le témoin **Panne** est allumé, le chargeur SurePower émet une alerte sonore. Ne pas utiliser cette batterie.

Nettoyage

Clean *SurePower II* Charger Adaptors with a soft cloth, mild soap, and water.

N'immergez pas les adaptateurs pour chargeur dans l'eau. N'utilisez pas d'alcool ou de cétones (méthyléthylcétone, acétone, etc.). Ne passez pas les adaptateurs pour chargeur à l'autoclave

Spécifications de l'adaptateur pour chargeur *SurePower II*

Taille	22,7 (longueur) x 14,6 (largeur) x 8,6 (hauteur) cm
Poids	0,8 kg
Type	IEC Classe I
Normes de conception	Respecte ou dépasse les normes applicables UL 60601-1, EN 60601-1.
Température de fonctionnement	0 °C à 50 °C
Température de stockage à court terme/transport	-40 °C à 70 °C
Humidité	Humidité relative, sans condensation, 30 à 93 %
Altitude de service	-91 m à 6096 m (au-dessous et au-dessus du niveau de la mer) 1060 à 500 mBar
Protection contre les particules et l'eau	IP X2